


Exploration de la douleur au Centre d'Investigation Clinique de Clermont-Ferrand CIC 1405

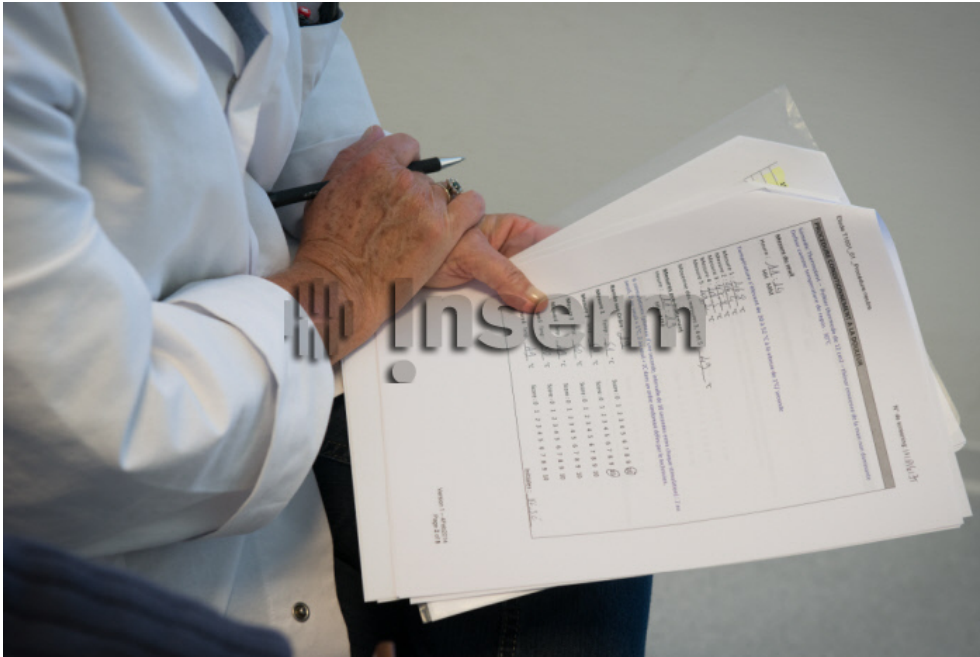

Référence

58512

Date

20140926

Titre

Exploration de la douleur au Centre d'Investigation Clinique de Clermont-Ferrand CIC 1405

Légende

Quantifier la douleur et analyser l'effet placebo. La thermode délivre de la chaleur dont la température monte progressivement. Dès que le stimulus commence à devenir douloureux, la patiente appuie sur un bouton presseur, relié à l'ordinateur, permettant ainsi de mesurer le seuil de sensibilité à la douleur thermique. Analyse des résultats.

Auteur

Copyright

Inserm/Begouen, Etienne

Instructions spéciales